


EM=420

LCMS Scan ESI+

Ret. Time: 1.58

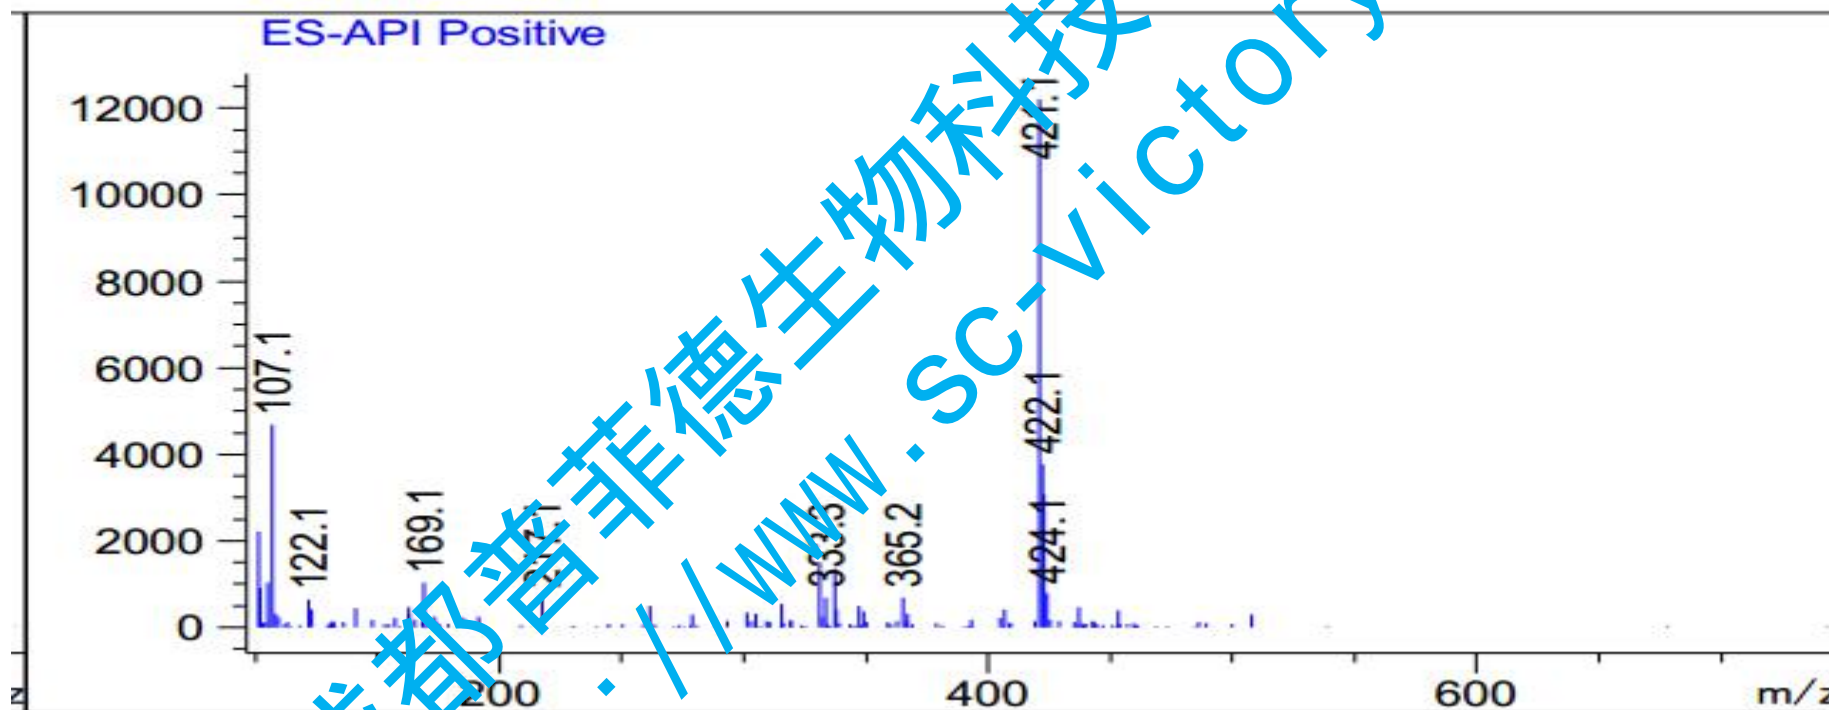


成都普菲德生物科技有限公司  
<http://www.sc-victory.com>

EM=420

LCMS Scan ESI-

Ret. Time: 1.56 <<<< NEGATIVE SPECTRA >>>>

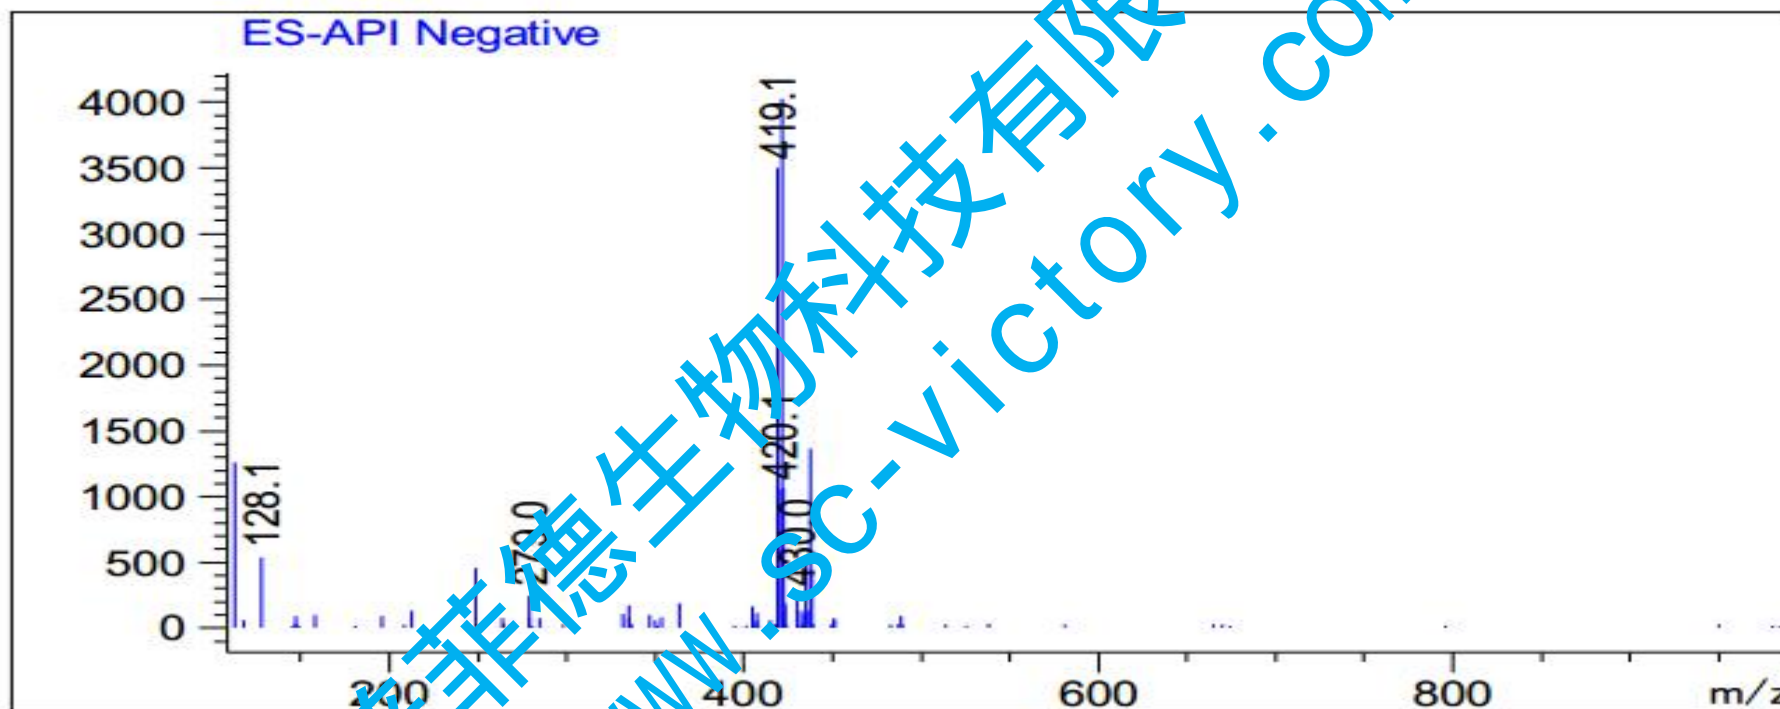

成都普菲德生物科技有限公司  
<http://www.sf-victory.com>